


Auswertung der Qualitätsprüfung

Gerätebezeichnung: TSRC10T-X
Typ: Ritchey-Chrétien-Astrograph
Öffnung / Brennweite (mm): 254/2000
Gerätenummer: TSRC10T-X 20221116 001
Prüfdatum: 16.11.2022

Testablauf in Autokollimation:


Künstlicher Stern im Unendlichen intra- und extrafokal.
Künstlicher Stern im Unendlichen fokal.

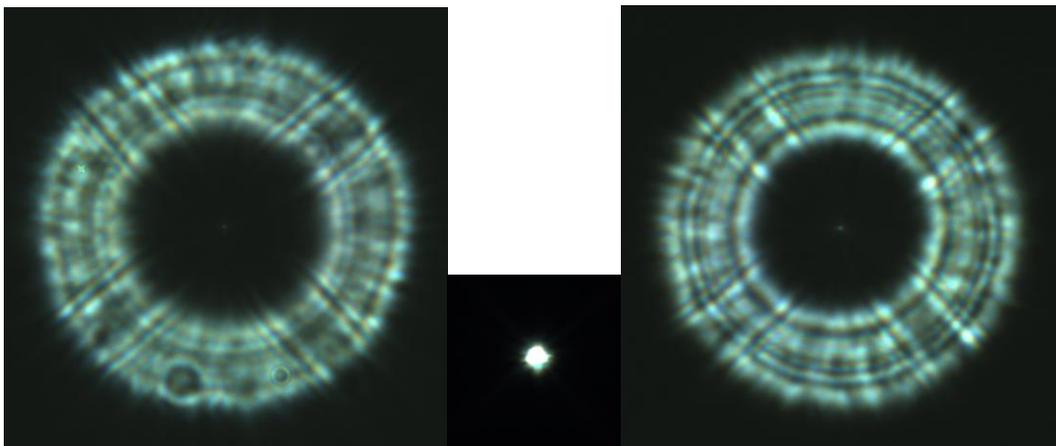

intrafokal

fokal

extrafokal

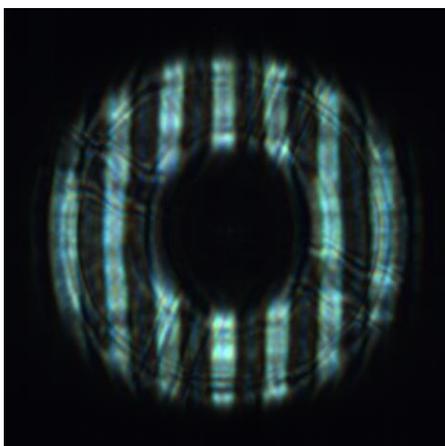

Ronchi

Die Prüfung des fokalen, sowie intra- und extrafokalen Sternbildes zeigt keine Auffälligkeiten. Der Ronchitest zeigt außer atmosphärisch bedingten Störungen keine Fehler. Die Qualität der Optik ist sehr gut und bei guter Kollimation und Auskühlung ist eine sehr gute Abbildung zu erwarten.